

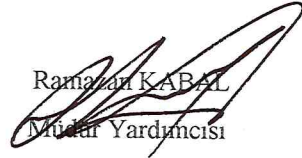
T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 20726106/
Konu : Teklif Formu
Sayın İLGİLİ

18.02.2019

İdaremizin ihtiyacı olan cins ve miktarı yazılı (1) kalem AERATÖR BAŞLIĞI ALIMI alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilecektir. Bu işin temin edilebilmesi için K.D.V. hariç birim fiyatlarının karşılıklarına yazılarak 21.02.2019 tarihine ve saat 10:00 kadar bildirilmesini .


Ramazan KABAL
Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	AERATÖR BAŞLIĞI (BİLYELİ) BUTONLU (LED IŞIKLI) STANDART BOY	2	ADET		
Toplam					

Diğer Hususlar:

- 1- Teklif mektubunda, teklif edilen bedel Türk Lirası (KDV Hariç) olarak, rakam veya yazı ile açıkça belirtilmiş olmalıdır.
- 2- Malzemenin teslim süresi tekliflerde belirtilecektir.
- 3- Ürünler verilen teklifler tamamı üzerinden değerlendirilecektir.
- 4- Söz konusu alımla ilgili tüm vergi-resim, harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.
- 5- İdareimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği miktarlarda yapmakta serbesttir.
- 6- Verilen mal/hizmet Yetkili personellerimiz tarafından kontrol edilip onay alan ürün/hizmet kabul edilecektir. Teknik Şartnameye uymayan mal/hizmet kabul edilmeyecektir.
- 7- Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir.
- 8- Teklif geçerlilik süresi 60 gündür.
9. Alım ile ilgili 1 sayfa teknik şartname yazımız ekindedir.
10. Cihazın UBB-ÜTS sistemine kaydı aranacaktır.
11. Alım ile ilgili bilgi almak için hastanemiz 03645110505 Dahili :2108 Biyomedikal Depoyu arayabilirsiniz.



T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ



TIBBİ CİHAZ/SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

TARİH :..../02/2019

ŞARTNAME NO:.....

KONU		
MALZEMENİN ADI	AERATÖR BAŞLIĞI (BİLYELİ) BUTONLU (LED IŞIKLI) STANDART BOY	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER		
İSTEK VE ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Aeratör başlığı adaptöre ihtiyaç olmadan ışık üretme sistemine sahip olmalı ve ışık devresi olmayan ünitelerde ışıklı olarak çalışabilmelidir. LED ışıklı olmalıdır.2. İnsan sağlığına uygunluğu, hassas ve ideal dengeye sahip olması ve mükemmel korozyon direncine sahip olması için başlığın tüm dış kısmının malzemesi paslanmaz çelik olmalıdır.3. Aeratör başlığının hızı 330.000(min)- 430.000(max) dev./dk. olmalıdır.4. Aeratör başlığı,2.2- 2.5 atmosfer basıncında randımanlı çalışmalıdır.5. Aeratör başlığı,rahat kullanım için en fazla 60 gr olmalıdır.6. Aeratör başlığı, seramik rulmanlı olmalıdır.7. Aeratör başlığının kafası standart tip olmalı ve en fazla 12.1x13.3 mm lik kafa çapı ile optimum görüş imkanı sağlamalıdır.8. Aeratör başlığıçdayanıklılığı artıran kapalı kartuş sistemine sahip olmalıdır.9. Aeratör başlığı, push button frez değiştirme ve ünite direk monte sisteminde olmalıdır.10. Aeratör başlığının çıkış gücü en az 16 W olmalıdır.11. Aeratör başlığının gövde yapısı kolay hijyen edilebilmesi için düz, hafif ve ergonomik yapıda olmalıdır.12. Aeratör başlığı, ağız içi tükürük, sıvı ve diğer yabancı maddelerin türbin kafasına girmesini önleyen, böylece uzun türbin ömrü sağlayan ve kontaminasyonu önleyen temiz kafa sistemine sahip olmalıdır. Bu işlemi başlık üzerinde en az 4 hava yoluyla yapmalıdır.13. Aeratör başlığı, en az dört(4) noktadan optimum soğutma sağlamalıdır.14. Aeratör başlığı, 135 dereceye kadar otoklavda steril edilebilir olmalıdır ve bu özellik başlık üzerinde silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.15. Termal dezenfektörde yıkanabilmelidir. Bu özellik başlık üzerinde belirtilmelidir.	
ZORUNLU ÖZELLİKLER		
İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)	İSTEĞİ YAPAN (Kaşe/İmza)
İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ Hüsnü PARMAKSIZ Teknisyen - N.K.1. Biyomedikal Depo Sorumlusu	Dt. Ali Eyten KARA Dış Hekimi Dr. Tels. 0302 317	İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ Ramazan KABAL İdari ve Mali İşler Müdür Yard.